



साँगुरीगढी गाउँपालिका

Sangurigadhi Rural Municipality

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

Office of the Rural Municipal Executive



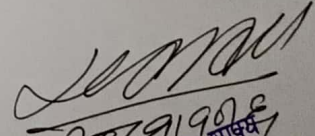
प.सं. ०८१/०८२

कोशी प्रदेश नेपाल  
Koshi Province Nepal

**Laboratory Equipment** क्याटलग सपिड सम्बन्धी सूचना रद्द गरिएको।

सूचना प्रकाशन मिति २०८१।१०।०६

यस कार्यालयले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ८ को उपदफा (१) को खण्ड (क) को उपखण्ड (\*८) भएको व्यवस्था र सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ३१ख. को उपनियम (२) बमोजिम क्याटलग विधिबाट Laboratory Equipment खरिद गर्न मिति २०८१/०७/२६ गते प्रकाशित सूचना बमोजिम पेश हुन आएका ब्रोसियरहरू उत्पादक वा अधिकृत बिक्रेताद्वारा निर्धारित दरमा खरिद गर्ने कार्यविधि २०७४ ले निर्धारण गरेको शर्त पुरा नभएकाले पुनः सूचना गर्ने निर्णय भए बमोजिम मिति २०८१/०७/२६ गते प्रकाशित क्याटलग सपिड विधिबाट **Laboratory Equipment** खरिद सम्बन्धी सूचना रद्द गरिएको सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

  
२०८१/१०/०६  
राज कुमार शास्त्री  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



साँगुरीगढी गाउँपालिका

Sangurigadhi Rural Municipality

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

Office of the Rural Municipal Executive

भेदेदार, धनकुटा  
Bhedetar, Dhankuta  
२०७३ (२०७३)



प.सं. ०८१/०८२

कोशी प्रदेश नेपाल

Koshi Province Nepal

**Laboratory Equipment** क्याटलग सपिड विधिबाट खरिद सम्बन्धी सूचना ।

दोस्रो पटक सूचना प्रकाशन मिति २०८१।१०।०६

यस कार्यालयले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ८ को उपदफा (१) को खण्ड (क) को उपखण्ड (\*८) भएको व्यवस्था र सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ३१ख. को उपनियम (२) बमोजिम क्याटलग विधिबाट Laboratory Equipment खरिद गर्नु पर्ने भएकाले देहायका सामग्री विक्री गर्न चाहाने उत्पादक वा आधिकारिक विक्रेताहरूले आफ्नो उत्पादनको आधिकारिक स्पेसिफिकेसन गुणस्तर मुल्य तथा अन्य सुविधा सहितको विवरण (Catalog or Browser) यो सूचना प्रकाशन भएको मितिले ७ दिन भित्र पेश गर्नु हुन सम्बन्धित सरोकारवालाहरूका लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।

### List Of Laboratory Equipments

S.N	Apparatus Name	Quantity	Unit
1	Compression Testing Machine 2000 KN Semi-Automatic with touch screen digital indicator and printer and should be software driven as per IS standard. Weight of Machine should be Approx. 550-600 Kg should be calibrated internally at the office site	1	PC
2	L.A Machine digital as per IS ( Rolling drum thickness should be minimum of 12 mm)	1	PC
3	Temperature Maintain Curing tank	1	PC
4	Motar vibrator digital should be as per IS standard , motar should be of 1HP of Godrej or perfect or honda	1	PC
5	Concrete Mixture electric Indian Made	1	PC
6	Vaibrating Machine electric 24"x24"	1	PC
7	Hot air oven digital 24*24 Inner chamber full stainless steel, heavy constrution for engineering lab	1	PC

*[Handwritten Signature]*  
२०८१।१०।०६

राज कुमार शाक्य  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत